


通常のAILS装着方法(装置メーカー推奨方法、米国でも実施)



JAMA推奨のAILS装着方法(今回の検証実験で採用)

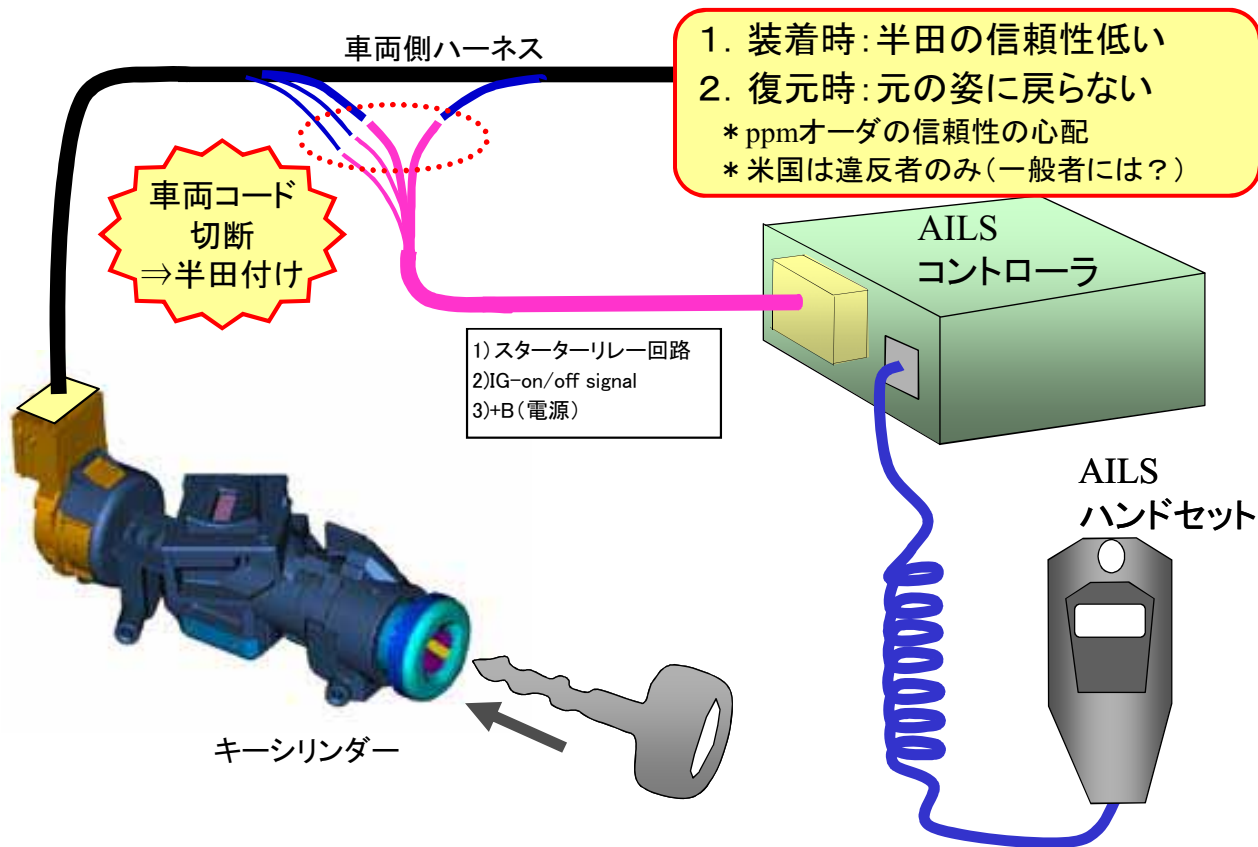